

1. INFORMAZIONE CLIENTE/MEDICO & FILE DEL PAZIENTE

Codice cliente (vedere bolla/fattura) :
 Nome del medico (che ha incontrato il malfunzionamento) :
 ID Paziente : (facoltativo)

AGGIUNGERE OBBLIGATORIAMENTE :
 - Una radiografia panoramica o settoriale di ogni fase del piano di trattamento (almeno quella post-disfunzione)
 - La radiografia dell'ultima visita prima della comparsa del malfunzionamento

2. TRACCIABILITA' ATTENZIONE : l'impianto e il pezzo protetico associato* devono essere restituiti puliti, decontaminati e sterilizzati

N° dente :

Impianto malfunzionante : Codice : sconosciuto Data di posa :
 Lotto : sconosciuto Data di rimozione :


Pezzo protetico associato* : Sì (complare) No (n/d)

*all'impianto al momento del malfunz. Codice : sconosciuto Data di posa :
 Lotto : sconosciuto Data di rimozione :

3. TIPO DI MALFUNZIONAMENTO

Blocco o disadattamento Frattura Attivazione (3.0) Altro :

4. INFORMAZIONI CHIRURGICHE (cerchiare sul grafico o spuntare n/d) n/d (protesi non effettuata)

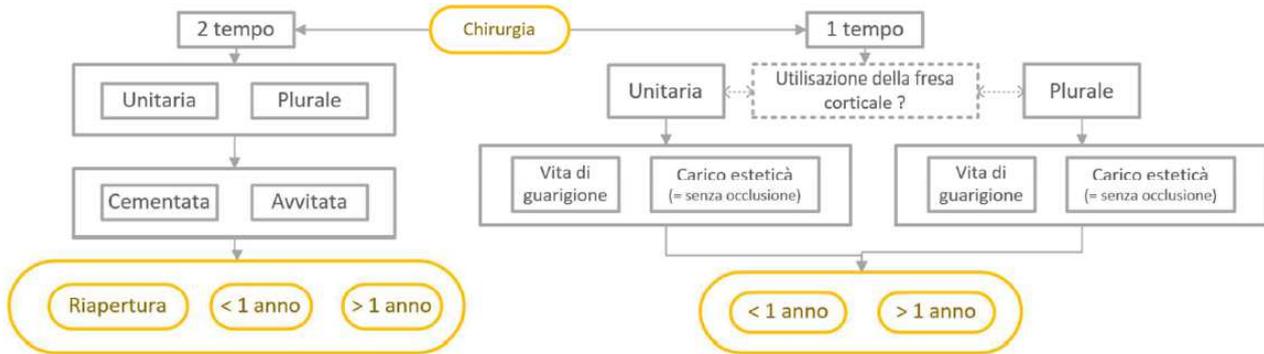

5. POSIZIONE DEL MALFUNZIONAMENTO

Vite di chiusura Collo dell'impianto Filettatura interna Connessione impianto Altro :

6. SITUAZIONE PRE/DURANTE/POST OPERATORIA

Bruxismo/ Sovraccarica biomeccanica Indicazione non-rispettata Malattia periodontale Trauma / Incidente
 Apertura orale insufficiente Buona salute generale Infezione locale
 Complicazione durante la preparazione del sito Altro :

Qualità ossea : D1 D2 D3 D4 NS*
 Se volume osseo insufficiente : ROG Innesto: tipo..... Brand & data JJ/MM/AAAA

7. INFORMAZIONI SULLA PROTESI

Situazione dell'antagonista

Dente naturale Protesi totale fissa impianto Apparecchio rimovibile
 Protesi totale fissa dentale Assenza dente Curva di Spee non restaurata

Materiale utilizzato sul dente restaurato

Resina Zircone laminato Materiali ibridi
 Ceramo-metallo (CCM) Full zircone Altro :

Monitoraggio e controlli del paziente

Numero di visite : Data ultima visita : JJ/MM/AAAA Controllo dell'occlusione e trattamento ad ogni visita : Sì No NS*

Commenti aggiuntivi :

.....